



ROVERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, Polska
tel. (+48 22) 737 11 95, fax (+48 22) 737 11 96
info@rovers.pl, www.rovers.pl



ISO 9001
FS 557303

ARTYKUŁY MEDYCZNE I LABORATORYJNE

Piaseczno, 25.01.2010 r.

Znak: 10/124/MH

Szpital Tucholski Sp. z o.o.

Ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Numer sprawy: NZOZ XII/25/09

PROTEST

Na podstawie art. 179 w związku z art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą” Wykonawca, tj. Rovers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zwany dalej „Protestującym”, jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku składa protest na czynności Zamawiającego tj.:

- Nie odrzuceniu oferty firmy Polmil - Sprzęt Medyczny w Pakiecie 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3.
- Oceny ofert - wybraniu najkorzystniejszej oferty firmy Polmil - Sprzęt Medyczny w Pakiecie 2.
- Nierówne traktowanie Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, a w związku z tym naruszenie art. 7 ust. 1

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, interes prawny Protestującego doznał uszczerbku w uzyskaniu zamówienia w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w powołanej ustawie zasad udzielania zamówienia publicznego.


W związku z powyższym Protestujący wnosi o :

- powtórzenie czynności Zamawiającego związanych z badaniem i oceną ofert w Pakiecie 2;



ROVERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, Polska
tel. (+48 22) 737 11 95, fax (+48 22) 737 11 96
info@rovers.pl, www.rovers.pl



ISO 9001
FS 557303

ARTYKUŁY MEDYCZNE I LABORATORYJNE

- odrzucenie oferty złożonej przez firmę Polmil - Sprzęt Medyczny w Pakiecie 2 jako niespełniającej wymogów Zamawiającego i niezgodnej z treścią SIWZ na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu w Pakiecie 2 bez udziału firmy Polmil - Sprzęt Medyczny.

Uzasadnienie

W dniu 20.01.2010 r. Protestujący powziął wiadomość o wyborze oferty firmy Polmil - Sprzęt Medyczny w Pakiecie 2 jako najkorzystniejszej. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Pakiet 2) Zamawiający wymagał: „Szczoteczki cytologiczne pakowane sterylnie, umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, **które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy**”. Niestety Zamawiający w tym postępowaniu nie wymagał przedstawienia przez oferentów dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP wraz ze złożoną ofertą.


Firma Polmil - Sprzęt Medyczny przedstawiła w Pakiecie 2 szczoteczki producenta: **Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. Ltd.** Zdaniem protestującego w/w szczoteczki nie spełniają wymagań SIWZ.

Zamawiający w przedmiocie zamówienia wyraźnie wskazuje na wymóg zaoferowania szczoteczek cytologicznych, które posiadają rekomendacje Ministerstwa Zdrowia. W „Opisie Programu - Sposób Realizacji Zadań” Ministerstwo Zdrowia wskazuje na konieczność wykonania rozmazu szczoteczkami cytologicznymi „typu cervex-brush”. Firma ROVERS wprowadziła w/w technikę pobierania wymazu cytologicznego na światową skalę. Oczywistym jest, że Polskie Ministerstwo Zdrowia w swoich zaleceniach zawarło intencję taką, że oryginalna szczoteczka Cervex-Brush® uzyskała pozytywną rekomendację Ministra Zdrowia dla techniki „typu cervex-brush”. Jednocześnie Koordynatorzy Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centralny Ośrodek Koordynujący) wymagają, aby szczoteczki cytologiczne posiadały liczne badania kliniczne potwierdzające ich przydatność w przesiewowych programach populacyjnych. Szczoteczki cytologiczne zaoferowane przez firmę Rovers Polska Sp. z o.o. spełniają wymagania Zamawiającego, gdyż posiadają liczne badania kliniczne i rekomendacje.



ROVERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, Polska
tel. (+48 22) 737 11 95, fax (+48 22) 737 11 96
info@rovers.pl, www.rovers.pl



ISO 9001
FS 557303

ARTYKUŁY MEDYCZNE I LABORATORYJNE

Ponadto Zamawiający winien prowadzić badania cytologiczne zgodnie z oficjalnym stanowiskiem właściwych instytucji, które to stanowisko zawarte zostało w opisie Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy. W przekazanej dokumentacji Organizatorzy Programu potwierdzili, że badania cytologiczne w Polsce prowadzone są zgodnie z „Dyrektywą Europejską dla zapewnienia jakości w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”.

Oświadczamy, że szczoteczka Rovers® Cervex-Brush® jest rekomendowana w Dyrektywie Europejskiej.

Firma Polmil - Sprzęt Medyczny przystępując do w/w postępowania w Pakiecie 2 popętniła nadużycie deklarując, że oferowane przez tę firmę chińskie szczoteczki produkowane przez Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. Ltd. posiadają rekomendacje Ministerstwa Zdrowia. Należy również nadmienić, że nie są znane żadne badania kliniczne zaoferowanych szczoteczek „PSM 5003 wachlarzyk”.


Protestujący chciałby nadmienić, iż Deklaracja Zgodności producenta Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. Ltd., którą posługuje się firma Polmil - Sprzęt Medyczny wystawiona została na szczotki medyczne jednorazowe, a nie na szczoteczki cytologiczne. Powoduje to, że w/w wykonawca w zakresie Pakietu 2 nie posiada ważnych dokumentów dopuszczających do obrotu na szczoteczki cytologiczne. Z informacji jaką podaje w/w producent (załącznik nr 1) wynika, że produkowane przez tę firmę szczotki medyczne jednorazowe służą do mycia medycznego sprzętu laboratoryjnego. Nie wszystkie szczotki medyczne są szczoteczkami cytologicznymi, a tożsamość produktu powinna wynikać z Certyfikatu CE wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą, a nie dobrowolne oświadczenia/deklaracje wystawione przez producenta czy dystrybutora. Przepisy w tym zakresie nie przewidują dowolności interpretacji, bo nie można w żaden sposób identyfikować oraz postawić znaku równości pomiędzy szczoteczką cytologiczną a szczotką medyczną.

Nie odrzucenie oferty firmy Polmil - Sprzęt Medyczny narusza interes prawny Protestującego, ponieważ oferta Protestującego spełnia wymagania zawarte w SiWZ i powinna zostać uznana przez Zamawiającego w Pakiecie 2 za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy.



ROVERS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, Polska
tel. (+48 22) 737 11 95, fax (+48 22) 737 11 96
info@rovers.pl, www.rovers.pl



ISO 9001
FS 557303

ARTYKUŁY MEDYCZNE I LABORATORYJNE

Przedstawione uzasadnienie, Protestujący uważa za zasadne podważając wybór Oferenta dla realizacji zamówienia w Pakiecie 2.

Wobec powyższym Protestujący wnosi jak na wstępie.

Niniejszy protest wnoszony jest w dniu 25.01.2010 r. co oznacza, iż Protestujący uczynił zadość wymaganiom określonym w art. 180 ust. 2 ustawy (tj. wnosi protest w terminie 7 dni od dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu).


Z poważaniem,

Załączniki:


1. Informacja jaką podaje producent
Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. Ltd.

*Prosimy o potwierdzenie otrzymania
niniejszego protestu
Na numer fax: 22 737 11 96*



ROVERS POLSKA Sp. z o.o.
Petrus Rovers M.Sc.
PREZES ZARZĄDU

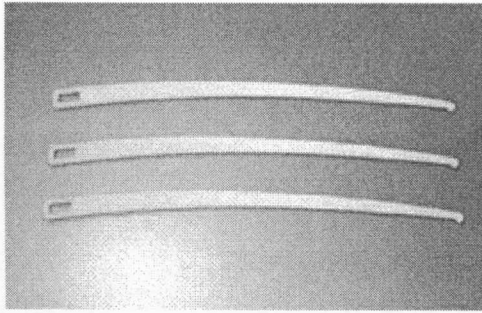


羊水勾 WY039
Amniotic membrane perforator
材料：ABS
规格：248 mm

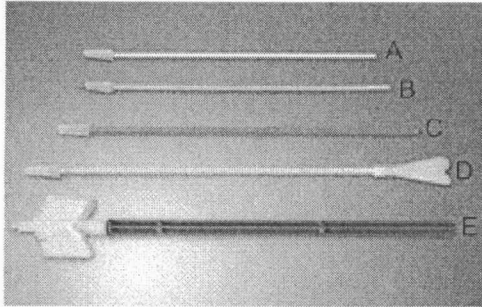

妇科刷 WY040-A、B、C、D、E
Cytology brush- tlum. Cytologiczna Szczoteczka

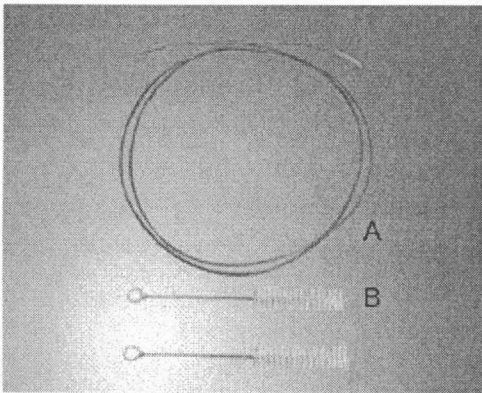

清洁刷 WY041-A、B
Medical brush- tlum.- Medyczna Szczotka

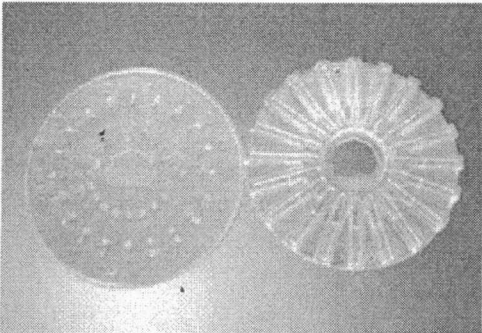

比色杯 WY042
Colorimetric cup

地 址:扬州市头桥镇通达路 邮编:225109

电 话:0514-87481431 87480600 传真:0514-87480500

联系人:刘为德 手机:(0)13605277548

网 址:www.yz-wuyang.com